



Benutzerhandbuch

Auto CPAP System

M1 Mini

C €₀₁₂₃

Inhaltsverzeichnis

1. Symbole	1
1.1 Steuerungstasten	1
1.2 Gerätesymbole	1
2. Warnung, Vorsicht und Wichtiger Tipp	2
3. Verwendungszweck	2
4. Kontraindikationen	4
5. Klinische Vorteile	5
6. Spezifikationen	5
7. Verfügbare Therapien	8
8. Glossar	8
9. Modell	10
10. Verpackungsinhalt	10
11. Systemfunktionen	11
12. Erstmögliche Einrichtung	12
12.1 LightTrip App Software herunterladen	12
12.2 Platzierung des Geräts	12
12.3 Installieren des Luftfilters und der Filterkappe	13
12.4 An die Stromversorgung anschließen	14
12.5 Zusammenbau des Schlauchs und der Maske	15
12.6 Verbindung über die drahtlose Bluetooth® -Technologie herstellen	16
12.7 Einstellung	16
12.8 Starten der Behandlung	17
13. Einsatz im Routinebetrieb	17
13.1 Anschließen der Schläuche	17
13.2 Einstellung des Schlauchs	17
13.3 Einschalten des Luftstroms	17
13.4 Verwenden der Rampenfunktion	17
13.5 Ausschalten des Geräts	18
14. Navigieren durch das Patientenmenü	18
14.1 Schritte zur Navigation durch das Patientenmenü	18
14.1.1 Zugang zur Einstellungsschnittstelle	18
14.1.2 Parameter einstellen und speichern	18
14.2 Optionen des Patientenmenüs und entsprechende Beschreibungen	19
14.2.1 Einstellung der Behandlung	19
14.2.2 Einstellung des Zubehörs	20

15. Eingabeaufforderung	20
16. Einführung von "Bericht"	22
17. Einführung von "Mehr"	22
18. Software aktualisieren	23
19. Die Reinigung und Desinfektion	23
19.1 Reinigung	24
19.1.1 Reinigen der Maske und des Kopfbandes	24
19.1.2 Reinigung der Schläuche	25
19.1.3 Austausch des Luftfilters	25
19.2 Desinfektion	25
19.2.1 Desinfektion der Maske und des Kopfbandes	25
19.2.2 Desinfektion der Schläuche	25
20. Reisen mit dem Gerät	25
20.1 Reisen	25
20.2 Reisen mit dem Flugzeug	26
21. Weitergabe des Geräts an einen anderen Patienten	27
22. Nachbestellung	27
23. Technische Unterstützung	27
24. Entsorgung	28
25. Fehlerbehebung	28
25.1 Häufige Probleme bei Patienten und entsprechende Lösungen	29
25.2 Häufige Probleme mit dem Gerät und entsprechende Lösungen	31
26. Anforderungen von EMV	32
27. Eingeschränkte Garantie	37

1. Symbole

1.1 Steuerungstasten



Bluetooth-Taste



Start/Stop-Taste

1.2 Gerätesymbole

	Gebrauchsanweisung befolgen		Chargencode
	Informationen für Importeure		Hersteller
	Typ BF Anwendungsteil (Maske)		Kennzeichnung von und Elektro-Elektronikgeräten
	Klasse II (Doppelisoliert)		Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	AC Leistung		CE-Kennzeichnung
	DC Leistung		Bluetooth-Logo
IP22	≥12,5 mm Durchmesser, Tropfend (15° geneigt)		Nicht ionisierende Strahlung
	Seriennummer		Logo der BMC Medical Co., Ltd.
	Entspricht RTCA DO-160 Abschnitt 21, Kategorie M.		Einzelner Patient - Mehrfachverwendung
	Medizinisches Gerät		Temperaturgrenze
	Einzigartiges Kennzeichen Gerät		Feuchtigkeitsbegrenzung
	Modellnummer		Luftdruckbegrenzung

	Hergestellt in China, Herstellungsdatum		Lufteintritt
	Luftaustritt		

VORSICHT!

- Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind geschützte Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von BMC unter Lizenz verwendet. Sonstige Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

2. Warnung, Vorsicht und Wichtiger Tipp**WARNUNG!**

Weisen Sie auf die Möglichkeit einer Verletzung des Benutzers oder Bedieners hin.

VORSICHT!

Weisen Sie auf die Möglichkeit einer Beschädigung des Gerätes hin.

WICHTIGER TIPP!

Verweisen Sie auf die Möglichkeit, dass ein solcher Vorgang die Wirksamkeit oder die Benutzerfreundlichkeit des Produkts beeinträchtigen kann.

Warnungen, Vorsichtshinweise und wichtige Tipps erscheinen in diesem Handbuch, wenn sie zutreffen.

3. Verwendungszweck

Das M1 Mini Auto CPAP-System ist ein CPAP-Gerät (kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck), welches für die Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) bei Erwachsenen im Krankenhaus oder zu Hause entwickelt wurde.

Das Gerät darf nur auf Anweisung einer zugelassenen medizinischen Fachperson bedient werden. Ihr Heimpflege-Dienstleister wird die korrekten Druckeinstellungen anhand der Verschreibung Ihres medizinischen Fachpersonals vornehmen.

Es sind verschiedene Zubehörteile erhältlich, um Ihre OSA-Behandlung mit diesem Gerät so bequem und komfortabel wie möglich zu gestalten. Um sicherzustellen, dass Sie eine sichere und effektive Therapie, wie sie verordnet wurde erhalten, verwenden Sie ausschließlich BMC-Zubehör.

WARNUNGEN!

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht für Lebenserhaltungs- Maßnahmen gedacht.
- Die Anweisungen in diesem Handbuch sind nicht gedacht für den Ersatz anerkannter medizinischen Protokolle.
- Bringen Sie das Gerät und das Zubehör nicht in eine Magnetresonanz-Umgebung (MR), weil dies zu einem inakzeptablem Risiko für den Patienten oder einer Beschädigung des Gerätes oder der MR-Medizinprodukte führen kann. Das Gerät und das Zubehör wurden nicht für die Sicherheit in einer MR-Umgebung evaluiert.
- Verwenden Sie das Gerät oder das Zubehör nicht in einer Umgebung mit elektromagnetischen Geräten wie CT-Scannern, Diathermie, RFID und elektromagnetischen Sicherheitssystemen (Metalldetektoren), weil dies zu einem inakzeptablen Risiko für den Patienten oder Schäden am Gerät führen kann. Manche elektromagnetischen Quellen sind unter Umständen nicht offensichtlich. Wenn Sie unerklärliche Veränderungen in der Leistung dieses Geräts merken, wenn es ungewöhnliche oder unangenehme Geräusche von sich gibt, trennen Sie das Netzkabel und beenden sie die Anwendung. Kontaktieren Sie Ihren Heimpflege-Dienstleister.
- Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Gerät auftreten, sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde in Ihrem Land gemeldet werden.
- Bringen Sie keine Duftstoffe oder Aromatherapiedüfte in das Innere des Geräts.
- Schlauchs oder der Maske entdecken, müssen Sie die Verwendung des Geräts sofort einstellen und den Anbieter Ihres Geräts kontaktieren.

VORSICHT!

- Dieses Gerät ist beschränkt auf Verkauf oder Bestellung durch einen Arzt.

WICHTIGE TIPPS!

- Lesen und verstehen Sie das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie dieses System in Betrieb nehmen. Falls Sie Fragen über Nutzen dieses Systems haben, kontaktieren Sie Ihren Heimpflege-Dienstleister oder Ihr medizinisches Fachpersonal.
- Die Bilder im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Falls diese unterschiedlich zum materiellen Gegenstand sind, ist letzterer maßgebend.
- Wenn Sie schon bei der ersten Verwendung des Geräts einen Geruch wahrnehmen, kann es sich um eine so genannte „Ausgasung“ handeln, die normal ist. Manche Patienten reagieren empfindlich auf den Geruch von Neuwagen oder bestimmten Kunststoffen; die Ausgasung ist ähnlich. Wenn Sie empfindlich auf diese Gerüche sind, wenden Sie sich an Ihren Anbieter

medizinischer Heimgeräte, um zu erfahren, wie Sie Ihr Gerät 8 Stunden bis 12 Stunden lang betreiben können. Dieser Prozess trägt dazu bei, den Geruch von neuem Kunststoff zu eliminieren, der sich mit der Zeit verflüchtigen wird.

4. Kontraindikationen

Studien haben ergeben, dass die folgenden Vorbedingungen bei einigen Patienten eine Kontraindikation für die Anwendung der positiven Atemwegstherapie darstellen können:

Absolute Kontraindikationen: Pneumothorax, Mediastinal-Emphysem; Cerebrospinal-Flüssigkeitsleck, traumatische Hirnverletzung oder Pneumozephalus; Schock welcher durch eine Vielzahl von Erkrankungen vor der Behandlung ausgelöst wird; aktive Epistaxis; obere gastrointestinale Blutung vor der Behandlung; Koma oder Bewusstseinsstörungen, die die Verwendung der Maske während der Therapie unmöglich machen; riesiger Stimmlippenpolyp, usw.

Relative Kontraindikationen: Schwere koronare Herzkrankheit mit komplizierter Linksherzinsuffizienz, akute Otitis media, übermäßige Sekretion der Atemwege und schwacher Husten, schwache Spontanatmung, nasale oder orale Trachealintubation und Tracheotomie, schwere Nasenverstopfung aufgrund verschiedener Erkrankungen, Lungenbläschen, Dehydrierung und Allergien gegen Atemmasken usw.

Die folgenden Nebenwirkungen könnten während der Behandlung auftreten:

- Trockenheit von Mund, Nase und Rachen
- Blähung im Bauchraum
- Ohren- oder Nebenhöhlenbeschwerden
- Augenreizung
- Hautreizungen durch die Verwendung einer Maske
- Beschwerden in der Brust

WICHTIGE TIPPS!

- Unregelmäßiger Schlafzeiten, Alkoholkonsum, Fettleibigkeit, Schlaftabletten oder Beruhigungsmittel können Ihre Symptome verschlechtern.
- Bitte verwenden Sie nur Masken, welche die Norm ISO 17510:2015 und die ISO 18562-Serie erfüllen.

VORSICHT!

- Kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal, falls die Symptome der Schlafapnoe wiederkehren. Wenn Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf Ihre Therapie haben, kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal.

5. Klinische Vorteile

- (1) Der klinische Vorteil der CPAP-Therapie besteht in einer Verringerung von Apnoen, Hypopnoen und Schläfrigkeit sowie in einer Verbesserung der Lebensqualität.
- (2) Der klinische Vorteil der Befeuchtung besteht in der Verringerung der mit dem positiven Atemwegsdruck verbundenen Nebenwirkungen.

6. Spezifikationen

Größe des Gerätes

Abmessungen: 159 mm × 66 mm × 72 mm

Gewicht: <400 g

Produktverwendung, Transport und Lagerung

Betrieb	Transport und Lagerung
Temperatur: 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)	-25°C bis 70°C (-13°F bis 158°F)
Luftfeuchtigkeit: ≤93% nicht kondensierend	≤93% nicht kondensierend
Umgebungsdruck: 760 hPa bis 1060 hPa	760 hPa bis 1060 hPa
Höhenlage: Meereshöhe bis 2300 m	Meereshöhe bis 2300 m
Hinweis: Dieses Gerät kann in Flugzeugen ohne Höhenbeschränkung betrieben oder transportiert werden.	

Betriebsart

Kontinuierlich

Arbeitsmodus

CPAP, AutoCPAP

Wechselstrom-Leistungsaufnahme

100 V bis 240 V $\sim$, 50 Hz/60 Hz, 1,0 A max

Eingang des Hauptgerätes

19 V, 1,26 A

Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag

Klasse II Gerät

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag

Typ BF Anwendungsteil

Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser

IP22

Druckbereich

4 hPa bis 20 hPa (in 0,5 hPa-Schritten), ≤ 30 hPa unter Einzelfehlerbedingungen.

Druckanzeige-Genauigkeit

0 bis 20 hPa, Fehlerspanne: $\pm(0,4 \text{ hPa} + 4\% \text{ des tatsächlichen Messwerts})$

Statische Druckstabilität

$\pm 0,5 \text{ hPa}$

Dynamische Druckstabilität

$\pm(0,5 \text{ hPa} + 5\% \text{ des eingestellten Drucks})$

Rampe

Die Rampenzeit beträgt von 0 bis 60 Minuten.

A-Gewichteter Schalldruckpegel und Schallleistungspegel

Wenn das Gerät bei einem Druck von 10 hPa betrieben wird, dürfen der Schalldruckpegel und der Schallleistungspegel die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten:

Schalldruckpegel	Ungewissheiten	Schallleistungspegel	Ungewissheiten
30 dB(A)	2 dB(A)	38 dB(A)	2 dB(A)

Hinweis: Doppelt bezifferte Geräuschemissionswerte, die gemäß ISO 4871:1996 veröffentlicht wurden.

Maximaler Durchfluss

Drücke von Testdrücke (hPa)	4	8	12	16	20
Gemessener Druck am Patientenanschluss (hPa)	3	7	11	15	19
Durchschnittlicher Fluss am Patientenanschluss (L/min)	85	125	110	110	95
Wenn der Arbeitsdruck auf die in der Tabelle aufgeführten Werte eingestellt ist, sollte die durchschnittliche Durchflussrate am Patientenende größer als 80% des entsprechenden Durchflusswerts in der Tabelle sein.					

Luftschläuche

Luftschläuche	Länge	Innendurchmesser
Schlauch	1,83 m (6 Fuß)	15 mm
Schlauch	1,83 m (6 Fuß)	19 mm

Die Form und die Abmessungen der Patientenanschlussöffnung

Der 22 mm konische Luftauslass entspricht der ISO 5356-1.

Luftfilter

Wirkungsgrad der Filtration: $>20\%$ für 10 Mikron

Material: Nicht gewebter Stoff und Polyester

Verwendung von Flugzeugen

BMC bestätigt, dass das Gerät die Anforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-160, Abschnitt 20, Kategorie T und Abschnitt 21, Kategorie M) für alle Phasen des Flugverkehrs erfüllt.

Informationen zur Bluetooth-Qualifizierung

Produktname: Auto CPAP-System

Modell: M1 Mini

DID: D051679

QDID: 154506

Bluetooth-Modul mit

Technologie: Bluetooth

Verbindungsarten: GATT

Frequenz: 2400 MHz bis 2483 MHz

Maximale RF-Ausgangsleistung: +4 dBm

Betriebsreichweite: 10 m (Klasse 2)

7. Verfügbare Therapien

Das Gerät liefert die folgenden Therapien:

CPAP – Bietet kontinuierlichen positiven Druck des Atemweg. Während des gesamten Atemzyklus bleibt CPAP ein konstantes Druckniveau.

AutoCPAP -Bietet die CPAP-Therapie und einen Luftdruck an, der nach den Bedürfnissen des Patienten nicht unter dem verordneten liegt.

8. Glossar

Apnoe

Ein Zustand, der durch das Beenden der spontanen Atmung geprägt ist.

AHI

Sie beschreibt die durchschnittliche Häufigkeit von Apnoen und Hypopnoen pro Stunde und entspricht dem Wert, der sich aus den Apnoe- und Hypopnoe-Zeiten der gesamten Nacht geteilt durch die Schlafzeit ergibt, wobei die Zeit pro Stunde gezählt wird.

Hypopnoe

Der Atemluftstrom ist um mehr als 30% reduziert, wobei die Sauerstoffdesaturierung mehr als 4% beträgt.

AutoCPAP

Stellen Sie den CPAP-Druck automatisch ein, um den Patientenkomfort auf Basis der Überwachung von Apnoe- und Schnarchereignissen zu verbessern.

Auto aus

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, hört das Gerät automatisch die Therapie auf, wenn die Maske entfernt ist.

Auto On

Mit dieser Funktion führt das Gerät automatisch die Therapie durch, wenn Sie in die Maske atmen. Diese Funktion ist immer eingeschaltet.

CPAP

Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck.

LPM

Liter pro Minute.

OSA

Obstruktive Schlafapnoe.

Patientenmenü

Sie können im Anzeigemodus die vom Patienten einzustellenden Geräteeinstellungen wie beispielsweise den Startdruck für die Rampenfunktion verändern.

Rampenzeit

Eine Funktion, die den Therapiekomfort für den Patienten zu Beginn der Therapie steigern kann. Es kann den Druck reduzieren und dann Schritt für Schritt bis zur verordneten Einstellung steigern, damit der Patient angenehmer einschlafen kann.

Reslex

Eine Therapiefunktion, die von Ihnen oder Ihrem Heimpflege-Dienstleister eingeschaltet wird, um eine Druckentlastung während der Ausatmung zu erreichen.

Standby-Zustand

Der Zustand des Geräts, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist. Aber der Luftstrom ist abgeschaltet.

Min.

Es bedeutet die Zeiteinheit "Minute".

h

Es bedeutet die Zeiteinheit "Stunde".

yy mm dd/mm dd yy/dd mm yy

Es bedeutet die Zeiteinheit Datum.

VORSICHT!

- Indexe wie Apnoe, AHI, Hypopnoe sind nur Überwachungsdaten, die vom Schlafapnoe-Therapiegerät geliefert werden, und keine diagnostischen Parameter.

9. Modell

Modell	Produkt-Beschreibung				
	Produktinhalt	Optionales Zubehör 1	Optionales Zubehör 2	Arbeitsmodus	Maximaler Arbeitsdruck (hPa)
M1 Mini	Hauptgerät, Steuerungssoftware für Mini Serienventilator (LightTrip App)	Tubing	Mask	CPAP, AutoCPAP	20

10. Verpackungsinhalt

Nachdem Sie das Systems auspacken, stellen Sie sicher, ob sie alle die hier gezeigten Dinge haben:

Nr.	Artikel	Quantität	Hinweise
1	Hauptgerät	1	
2	Schlauchs	1	Optional
3	Maske	1	Optional
4	Luftfilters	2	
5	Netzteil	1	
6	Aufbewahrungstasche	1	Optional
7	Tragetasche	1	Optional
8	Angehängte Dokumente	1	

Alle Teile und Zubehörteile sind nicht mit Naturkautschuklatex produziert.

Die voraussichtliche Lebensdauer des Geräts beträgt fünf Jahre ab dem ersten Gebrauch, wenn Gebrauch, Wartung, Reinigung und Desinfektion streng nach der Gebrauchsanweisung erfolgen.

Die Lebensdauer des Schlauchs und der Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Maske und des L1-Schlauchs.

Anhand den Normen des Netzadapter von verschiedenen Länder sind unterschiedliche Netzadapter inkludiert.

IMPORTANTS!

- Wenn es eines der oben erwähnten Teile fehlt, kontaktieren Sie Ihren Heimpflege-Dienstleister.
- Kontaktieren Sie Ihre Heimpflege-Dienstleister, um Sie sich weitere Informationen nach der

verfügbaren Zubehörteile dieses Geräts zu erkundigen. Wenn Sie die optionalem Zubehörteile nutzen, folgen Sie bitte den Anweisungen, die dem Zubehör beiliegen.

WARNUNG!

- Dieses Gerät darf nur mit den von BMC produzierten oder empfohlenen Masken und Zubehörteilen oder mit denen, die von Ihrem verschreibenden Arzt empfohlen werden, verwendet werden. Die Anwendung von ungeeigneten Masken und Zubehörteilen kann die Wirkung des Geräts beeinträchtigen und die Effizienz der Therapie mindern.
- Bei Überschreitung der zu erwartenden Lebensdauer kann unser Unternehmen weder für die normale Funktion des Gerätes noch für die Sicherheit und Wirksamkeit des Gerätes garantieren.

11. Systemfunktionen

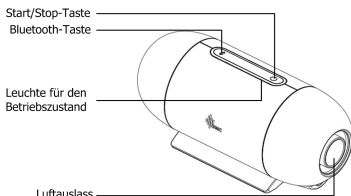


Abb. 11-1

Name	Funktion
Start/Stop-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Luftzufuhr zu starten/stoppen. Die Anzeige leuchtet weiß.
Bluetooth-Taste	Drücken Sie diese Taste, um eine Verbindung zur drahtlosen Bluetooth-Technologie herzustellen; doppelklicken Sie auf diese Taste, um die Verwendung der drahtlosen Bluetooth-Technologie zu beenden. Die Kontrollleuchte leuchtet blau.
Luftauslass	Liefert Druckluft; wird mit dem Schlauch oder dem Lufteinlass des Luftbefeuchters verbunden.
Leuchte für den Betriebszustand	Diese Leuchte ist im Normalzustand weiß und sie wird orange leuchten, wenn eine Warnmeldung erscheint.

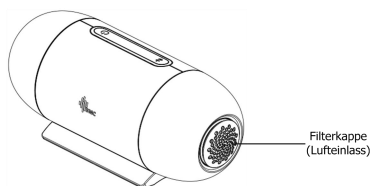


Abb. 11-2

Name	Funktion
Filterkappe (Lufteinlass)	Setzen Sie die Kappe auf den Luftfilter, welcher als Filtern von Staub und Pollen in der in das Gerät eintretenden Luft verwendet ist.

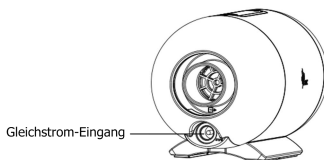


Abb. 11-3

Name	Funktion
Gleichstrom-Eingang	Ein Eingang für die Gleichstromversorgung.

12. Erstmalige Einrichtung

12.1 LightTrip App Software herunterladen

LightTrip App im App-Store suchen und herunterladen.

Unterstützt Android-Plattform und iOS-Plattform.

12.2 Platzierung des Geräts

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche. Die an der Unterseite des Geräts installierte Anti-Rutsch-Polsterung dient zum Befestigen des Geräts praktisch.

WARNUNGEN!

- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder falsch bedient wurde, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder wenn Wasser in das Gehäuse eingedrungen ist, trennen Sie das Netzkabel und hören Sie Bedienen auf. Kontaktieren Sie sofort an Ihren Heimpflege-Dienstleister.
- Wenn die Raumtemperatur wärmer als 35°C ist, kann der vom Gerät erzeugte Luftstrom 43°C überschreiten. Während dem Betrieb von Patient muss die Raumtemperatur unter 35°C (95°F) bleiben.

VORSICHTSHINWEISE!

- Wenn das Gerät entweder sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen eingesetzt wurde, lassen Sie es sich an die Raumtemperatur (20°C, ungefähr 2 Stunden) anpassen, bevor Sie mit der Inbetriebnahme anfangen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Heiz- oder Kühlgeräten steht (z. B. Lüftungsöffnungen, Heizkörper, Klimaanlage).
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Stellen Sie sicher, dass Bettzeug, Vorhänge oder andere Gegenstände den Filter oder die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht blockieren.
- Achten Sie darauf, dass Haustiere, Ungeziefer oder Kinder ferngehalten werden und dass keine kleinen Objekte eingeatmet oder verschluckt werden können.
- Um eine Explosion zu vermeiden, muss dieses Gerät nicht in Gegenwart von brennbaren Gasen (z. B. Anästhetika) verwendet werden.
- Tabakrauch kann Teerablagerungen im Gerät verursachen, welche zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
- Die Luft muss frei um das Gerät herum strömen, damit es einwandfrei funktionieren kann.

12.3 Installieren des Luftfilters und der Filterkappe

(1) Hängen Sie den Luftfilter an der Filterkappe an, wie in Abb. 12-1 dargestellt.




Abb. 12-1

(2) Installieren Sie die Filterkappe mit dem Luftfilter am Hauptgerät, wie in Abb. 12-2 dargestellt.




Abb. 12-2

VORSICHT!

- Während Betrieb des Geräts muss der Luftfilter eingesetzt sein.
- Bitte wechseln Sie den Luftfilter regelmäßig und blockieren Sie ihn nicht; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen sind verboten.
- Es wird empfohlen, die vom Hersteller gelieferten Luftfilter zu verwenden. Sonst können Fremdkörper oder Gerüche in das Gerät gelangen.

12.4 An die Stromversorgung anschließen

- (1) Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in den DC-Eingang des Geräts.
- (2) Stecken Sie das andere Ende des Netzadapters in die Netzsteckdose.




Abb. 12-3

WARNUNGEN!

- Das Gerät ist für den Betrieb eingeschaltet, wenn der Netzadapter angeschlossen ist. Die Taste  ist für Ein-/Ausstellen des Gebläses vorgesehen.
- Der Einsatz des Geräts bei einer Wechselspannung außerhalb des festgelegten Bereichs (siehe Abschnitt 6 "Wechselstromaufnahme") kann das Gerät zerstören oder einen

Gerätefehler verursachen.

- Stellen Sie das Gerät nicht an einem schwer zugänglichen Ort auf, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Stapeln Sie keine zu langen Kabel oder Schläuche am Kopfende des Bettes, die den Kopf oder Nacken des Patienten während des Schlafs einklemmen könnten.

VORSICHT!

- Überprüfen Sie das Kabel des Netzteils häufig auf Anzeichen von Schäden. Tauschen Sie einen beschädigten Netzadapter sofort aus.

WICHTIGER TIPP!

- Nach dem Unterbrechen und Wiederherstellen der Spannungsversorgung wird das Gerät automatisch den Arbeitszustand vor der Unterbrechung wiederherstellen.

12.5 Zusammenbau des Schlauchs und der Maske

(1) Schließen Sie das eine Ende des Schlauchs an den Luftauslass des Hauptgeräts an, wie in Abb. 12-4 dargestellt.

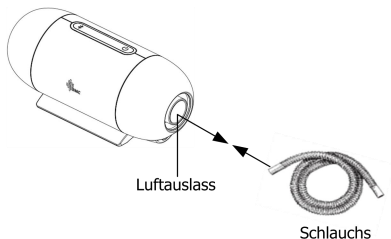


Abb. 12-4

(2) Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs mit der Maske anhand der Gebrauchsanweisung für die Maske an. Tragen Sie die Maske.

WARNUNGEN!

- Wenn das Gerät von mehreren Personen verwendet wird (z. B. bei Leihgeräten), sollte ein niederohmiger Hauptstrom-Bakterienfilter in der Leitung zwischen Gerät und Schlauch montiert werden. Die Drücke müssen von Ihrem Heimpflege-Dienstleister überprüft werden, wenn alternatives oder optionales Zubehör eingesetzt wird.
- Wenn Sie eine Maske mit einem integrierten Ausatemanschluss nutzen wollen, schließen Sie

den Anschluss der Maske an den Schlauch an.

- Wenn Sie eine Maske mit einer separaten Ausatemöffnung benutzen, schließen Sie den Schlauch an die Ausatemöffnung an. Positionieren Sie den Ausatemanschluss in der Weise, dass die Ausatemluft von Ihrem Gesicht weggeblasen wird. Verbinden Sie den Anschluss der Maske mit der Ausatemöffnungsöffnung.
- Wenn Sie eine Vollgesichtsmaske tragen (eine Maske, die gleichzeitig Mund und Nase bedeckt), muss die Maske mit einem Sicherheitsventil (Entrainment) ausgestattet sein.
- Um das Risiko einer CO₂-Rückatmung zu verhindern, sind die folgenden Hinweise vom Patienten zu beachten:
 - Verwenden Sie den beiliegenden Schlauch und die Maske, die von BMC bereitgestellt werden.
 - Tragen Sie die Maske nicht länger als einige Minuten, wenn das Gerät nicht betrieben ist.
 - Blockieren Sie nicht die Entlüftungsöffnungen in der Ausatemöffnung und versuchen Sie nicht, diese abzudichten.
- Falsche Anwendung einer Maske oder eines Zubehörs, das die Rückatmung von Kohlendioxid minimiert oder Spontanatmung ermöglicht, kann zu Erstickung führen.
- Wenn es im Schlauch Kondenswasser gibt, entfernen Sie den Schlauch und entleeren Sie ihn. Verringern Sie die Befeuchtungseinstellung.
- Um zu verhindern, dass sich der Schlauch oder das Schlauchsystem während der Anwendung löst, insbesondere bei ambulanter Anwendung, sollten nur Schläuche verwendet werden, die den Normen ISO 5367 oder ISO 80601-2-74 entsprechen.
- Verwenden Sie es nicht mit Sauerstoff.

12.6 Verbindung über die drahtlose Bluetooth® -Technologie herstellen

Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an. Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Hauptgerät und die Bluetooth-Anzeigeleuchte blinkt. Öffnen Sie dann die LightTrip App, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, um das Gerät zu suchen. Wählen Sie das Gerät in der Geräteliste anhand der Seriennummer des Geräts auf dem Typenschild aus, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung über die Bluetooth-Funktechnologie erfolgreich ist, leuchtet die Bluetooth-Betriebsanzeige des Hauptgeräts auf.

12.7 Einstellung

Klicken Sie in der LightTrip App auf "Einstellungen" und "Zubehör", um auf die entsprechende Einstellungsschnittstelle zu gelangen. Sehen Sie unter "14. Navigieren im Patientenmenü" in diesem Handbuch nach, um detaillierte Informationen der Schnittstelle zu erhalten.

12.8 Starten der Behandlung

Drücken Sie die **Start/Stop-Taste**  oder klicken Sie auf das Symbol  in der LightTrip App, dann fängt das Gerät mit der Luftzufuhr an.

WARNUNGEN!

- Beachten Sie unbedingt die Anweisungen Ihres Arztes zur Anpassung der Einstellungen. Um ein nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör zu bestellen, kontaktieren Sie Ihren Ausrüstungslieferanten.
- Schließen Sie KEINE Zusatzgeräte an dieses Gerät an, solange dies nicht von BMC oder Ihrem Arzt empfohlen wird. Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts unter Beschwerden in der Brust, Kurzatmigkeit, Magenblähungen oder starken Kopfschmerzen leiden, kontaktieren Sie sofort an Ihren Arzt oder qualifiziertes medizinisches Personal.

13. Einsatz im Routinebetrieb

13.1 Anschließen der Schläuche

Schließen Sie den Netzadapter und die Schläuche anhand der Anweisungen in der Erstinbetriebnahme (Kapitel 12) richtig an. Schließen Sie die Maske und das Kopfband anhand der Gebrauchsanweisung für die Maske an.

VORSICHT!

- Vor jedem Gebrauch prüfen Sie den Schlauch, ob es Beschädigungen oder Ablagerungen gibt. Reinigen Sie den Schlauch bei Bedarf, um Verunreinigungen zu entfernen. Ersetzen Sie einen beschädigten Schlauch. Stellen Sie sicher, dass die Maske nicht undicht ist.

13.2 Einstellung des Schlauchs

Legen Sie sich auf Ihr Bett, und stellen Sie den Schlauch so ein, dass er sich während des Schlafes frei bewegen kann. Passen Sie die Maske und das Kopfband soweit an, bis Sie einen angenehmen Sitz haben und keine Luftströmungslecks um die Maske herum mehr sind.

13.3 Einschalten des Luftstroms

Drücken Sie die **Start-/Stop-Taste**  oder klicken Sie auf das Symbol  in der LightTrip App, um den Luftstrom einzuschalten. Die LightTrip App wird Ihnen den Behandlungsdruck und andere Informationen anzeigen.

13.4 Verwenden der Rampenfunktion

Wenn die Rampenfunktion eingeschaltet ist, wird der Druck entsprechend der voreingestellten Rampenzeit vom Anfangsdruck stufenweise auf den vorgeschriebenen Behandlungsdruck

gesteigert, damit der Patient leicht einschlafen kann. Die LightTrip App zeigt einen Echtzeit-Countdown der verbleibenden Rampenzeit in Minuten an.

VORSICHT!

- Die Rampenfunktion ist nicht für alle Benutzer vorgeschrieben.

13.5 Ausschalten des Geräts

Entfernen Sie die Maske und das Kopfband, drücken Sie die **Start/Stop-Taste**  oder klicken Sie auf das Symbol  in der LightTrip App, dann wird das Gerät die Luftzufuhr aufhören. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, um das Gerät auszuschalten.

14. Navigieren durch das Patientenmenü

14.1 Schritte zur Navigation durch das Patientenmenüs

14.1.1 Zugang zur Einstellungsschnittstelle

Schließen Sie den Netzadapter ordnungsgemäß an. Schalten Sie das Gerät und die LightTrip APP für die Drahtlose Bluetooth-Technologie-Verbindung ein. Nachdem die Drahtlose Bluetooth-Technologie-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie Drahtlose Bluetooth-Technologie-Verbindung auf "Einstellungen" und "Zubehör", um auf die entsprechende Schnittstelle der Parameter zu gelangen.

14.1.2 Parameter einstellen und speichern

In der Schnittstelle der Parametereinstellung können Sie die Parameter nach Ihren Wünschen einstellen. Nachdem Sie die Parameter eingestellt haben, müssen Sie diese speichern. Die Parametereinstellung damit abgeschlossen.

14.2 Optionen des Patientenmenüs und entsprechende Beschreibungen

14.2.1 Einstellung der Behandlung

Option	Bereich	Beschreibung
Rampenzeit	0 bis 60 Min./ Auto	Um den Wohlbefinden zu erhöhen und dem Patienten das leichte Einschlafen zu ermöglichen, kann der Druck stufenweise erhöht werden, wenn die Rampenfunktion eingeschaltet ist. Die Rampenzeit, in der der Anfangsdruck auf den vorgeschriebenen Behandlungsdruck ansteigt, kann eingestellt werden. Die Zahlenwert nimmt in Fünfminuten-Schritten zu oder ab. Die LightTrip App zeigt einen Echtzeit-Countdown der restlichen Rampenzeit in Minuten an.
Reslex	Aus/1/2/3	Diese Funktion ermöglicht es dem Gerät, den Behandlungsdruck automatisch zu reduzieren, wenn der Patient ausatmet, damit sich der Benutzer wohler fühlt. Je größer der Zahlenwert ist, desto mehr Druck baut das Gerät ab.
Auto on	An/Aus	Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, fängt das Gerät automatisch an, Luft unter dem vorgegebenen Druck abzugeben, nachdem der Patient eine Atemmaske aufsetzt und mehrere Tiefenatmungen macht. Klicken Sie entsprechend um "An" oder "Aus" zu wählen.
Auto aus	An/Aus	Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, hört das Gerät automatisch auf, Luft zuzuführen und schaltet sich ab, nachdem der Patient die Atemmaske entfernt hat. Klicken Sie entsprechend um "An" oder "Aus" zu wählen.
Schlauchtyp	19 mm/15 mm	Es gibt zwei Arten von Schläuchen. Klicken Sie entsprechend um "19 mm" oder "15 mm" auszuwählen.
Maskentyp	Vollgesichtsma- ske/Vollgesicht smaske/Nasen- kissenmaske/ Andere Maske	Es gibt drei Typen von Masken, nämlich Vollgesichtsmaske (Vollgesichtsmaske), Vollgesichtsmaske (Nasalmaske) und Nasenkissenmaske (Nasen-Kissenmaske). Aber der Patient kann auch andere geeignete Masken auswählen. Bei der Auswahl von anderen Masken als den oben erwähnten drei Typen von BMC-Masken kann der Patient die Masken als andere identifizieren.
Feuchtigkeitsaustauschertyp	Keiner/ Basis Version/ Verbesserte Version	Sie können je nach dem Typ des Feuchtigkeitsaustauschers der Maske ausgewählt werden.

14.2.2 Einstellung des Zubehörs

Option	Bereich	Beschreibung
Luftfilter	Aus/7 Tage/14 Tage/21 Tage/30 Tage/ 60 Tage/90 Tage	Stellen Sie den Luftfilter-Erinnerungszyklus ein, dadurch wird er den Benutzer nach Ablauf des Zyklus benachrichtigt.
Maske	Aus/ 30 Tage bis 720 Tage	Stellen Sie den Maske-Erinnerungszyklus ein, dadurch wird er den Benutzer nach Ablauf des Zyklus benachrichtigt. Die Schrittweite für Einstellung beträgt 30 Tage.
Schlauch	Aus/ 30 Tage bis 720 Tage	Stellen Sie den Schlauchs-Erinnerungszyklus ein, dadurch wird er den Benutzer nach Ablauf des Zyklus benachrichtigt. Die Schrittweite für Einstellung beträgt 30 Tage.
Feuchtigkeits tauscher	Aus/7 Tage/14 Tage/ 21 Tage/28 Tage	Stellen Sie den moisture exchanger-Erinnerungszyklus ein, dadurch wird er den Benutzer nach Ablauf des Zyklus benachrichtigt. Die Schrittweite für Einstellung beträgt 7 Tage.
Tage seit der letzten Wartung	Aus/180 Tage/360 Tage	Stellen Sie den cleaning and maintenance-Erinnerungszyklus ein, dadurch wird er den Benutzer nach Ablauf des Zyklus benachrichtigt.

15. Eingabeaufforderung

Prompt-Meldung	Beschreibung
Stromausfall!!!	Wenn das Gerät bei der Luftabgabe unbeabsichtigt von der Stromversorgung unterbrochen wird und das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung "Stromausfall!!!" erscheinen. Hinweis: Im Ruhezustand erscheint die Aufforderung nicht, wenn der Stromausfall auftritt.
Gerätefehler!!!	Wenn kein Luftstrom während des Betriebes des Gerätes herauskommt, wird die Statusleuchte des Geräts blinken. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung "Gerätefehler !!!" angezeigt.
Leck!!	Wenn es eine große Menge an Luftundichtigkeiten beim Ausschalten der automatischen Abschaltfunktion im Gerät gibt, wird die Statusleuchte des Geräts blinken. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung "Leck!!" angezeigt.

Niedrige Eingangsspannung!!	Wenn die vom Netzadapter gelieferte Spannung zu niedrig ist, wird die Statusleuchte des Geräts blinken. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung " Niedrige Eingangsspannung!! " angezeigt.
Bitte Einlassfilter wechseln!	Wenn der Erinnerungszyklus des Luftfilters eingestellt ist, blinkt die Statusleuchte des Geräts, wenn der voreingestellte Erinnerungszyklus erreicht wird, aber ohne dass der Luftfilter ausgetauscht wird, und setzt den Erinnerungszyklus zurück. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung " Bitte Einlassfilter wechseln! " angezeigt.
Bitte ersetzen Sie den Schlauch!	Wenn der Erinnerungszyklus für den Schlauch eingestellt ist, blinkt die Statusleuchte des Geräts, wenn der voreingestellte Erinnerungszyklus erreicht wird, ohne dass der Schlauch ausgetauscht wird, und setzt den Erinnerungszyklus zurück. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung " Bitte ersetzen Sie den Schlauch! " angezeigt.
Bitte ersetzen Sie die Maske!	Wenn der Erinnerungszyklus für den Maske eingestellt ist, blinkt die Statusleuchte des Geräts, wenn der voreingestellte Erinnerungszyklus erreicht wird, ohne dass der Maske ausgetauscht wird, und setzt den Erinnerungszyklus zurück. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung " Bitte ersetzen Sie die Maske! " angezeigt.
Bitte ersetzen Sie den Feuchtigkeitstauscher!	Wenn der Erinnerungszyklus für den Feuchtigkeitstauscher eingestellt ist, blinkt die Statusleuchte des Geräts, wenn der voreingestellte Erinnerungszyklus erreicht wird, ohne dass der Feuchtigkeitstauscher ausgetauscht wird, und setzt den Erinnerungszyklus zurück. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung " Bitte ersetzen Sie den Feuchtigkeitstauscher! " angezeigt.
Bitte reinigen und warten!	Wenn der Erinnerungszyklus für den reinigung und instandhaltung eingestellt ist, blinkt die Statusleuchte des Geräts, wenn der voreingestellte Erinnerungszyklus erreicht wird, ohne dass der reinigung und instandhaltung, und setzt den Erinnerungszyklus zurück. Wenn das Hauptgerät über Drahtlose Bluetooth-Technologie mit der LightTrip App verbunden ist, wird in der LightTrip App die Meldung " Bitte reinigen und warten! " angezeigt.

16. Einführung von "Bericht"

Benutzer können wählen, ob sie die Nutzungsberichte, die an einem bestimmten Tag oder in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden, je nach Bedarf anzeigen möchten. Benutzer können Tastenkombinationen zur schnellen Abfrage oder die Abfrage des Zeitraums personalisieren.

Statistische Informationen	Bereich	Beschreibung
Ergebnis	0 bis 100	Abhängig von der Nutzungsdaten des gewählten Zeitraums wird der Nutzungseffekt mit unterschiedlichen Gewichtungen kalkuliert.
Nutzungseffekt:		
Nutzungszeit	0 bis 60/60	Die Punktzahl wird entsprechend der Nutzung durch den Benutzer im ausgewählten Zeitraum berechnet. Der Teil "0 bis 60" repräsentiert die Wert der Nutzungszeit, wobei die absolute Wert 60 beträgt.
Leck	0 bis 20/20	Die Punktzahl wird entsprechend der Luftverlust im ausgewählten Zeitraum berechnet. Der Teil "0 bis 20" repräsentiert die Wert der Luftverlust, wobei die absolute Wert 20 beträgt.
AHI	0 bis 20/20	Die Punktzahl wird entsprechend der Anzahl der AHI-Vorkommen im ausgewählten Zeitraum berechnet. Der Teil "0 bis 20" repräsentiert die Wert der AHI-Index, wobei die absolute Wert 20 beträgt.

Für die obigen Daten können Sie auch auf das Säulendiagramm der einzelnen Elemente klicken, um den Trend des Einzeleffekts zu analysieren.

Außer den oben erwähnten Daten beinhaltet der Bericht auch detaillierte Statistiken über Nutzung, Druck, Atemindex und Luftleckagen.

17. Einführung von "Mehr"

Option	Beschreibung
Druckeinheit	Benutzer können die Druckmesseinheit zwischen "hPa" oder "cmH ₂ O" wählen. Die Standardeinstellung ist "cmH ₂ O".
Schlafdaten hochladen	Benutzer können entscheiden, ob Schlafdaten auf die Cloud-Plattform hochgeladen werden sollen. Wenn das Hochladen von Schlafdaten ausgewählt wurde, wird Gerät automatisch Schlafdaten auf die Cloud-Plattform hochladen.
Löschen von Daten	Benutzer können wählen, ob die in der APP oder im Hauptgerät gespeicherten Daten gelöscht werden sollen.

Außer den oben erwähnten Funktionen können Benutzer auch weitere Informationen anzeigen. Lesen Sie das Handbuch der BMC-Mini-App für weitere Details.

18. Software aktualisieren

Wenn es eine neue Version der LightTrip-App oder der Gerätefirmware gibt, erscheint beim Öffnen der LightTrip-App eine Eingabe-Aufforderung. Entsprechend der Aufforderung können die Software und die Firmware aktualisiert werden.

VORSICHTSHINWEISE!

- Bitte halten Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen APP und Hauptgerät während des Firmware-Upgrades aufrecht.
- Um die beste Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir, die neueste Version der BMC-Mini-App und der Gerätefirmware zu nutzen.

19. Die Reinigung und Desinfektion

WARNUNGEN!

- Die regelmäßige Reinigung des Geräts und seines Zubehörs spielt eine wichtige Rolle für die Vorbeugung von Atemwegsinfektionen.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, trennen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker des Geräts.
- Verwenden Sie Waschmittel, das für den Menschen ungiftig ist und keine Allergien beim Menschen verursachen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Reinigung von Maske und Schlauch und zur Häufigkeit der Reinigung.
- Öffnen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen und Wartungsarbeiten sollten nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Spülen Sie nach der Desinfektion alle desinfizierten Teile gründlich mit Wasser ab, insbesondere solche, die in engem Kontakt mit dem Patienten stehen, wie Masken, Kopfbänder und Schlauch, um zu verhindern, dass Desinfektionsmittelreste die Haut oder die Atemwege schädigen oder Allergien auslösen.
- Es ist nicht gestattet, dieses Gerät und seine Komponenten über die empfohlenen Werte hinaus zu desinfizieren, da der Hersteller sonst nicht in der Lage ist, die Sicherheit oder Leistung des Geräts zu überprüfen.
- Um eine Kreuzinfektion des Patienten oder eine Kontamination des Gerätes zu verhindern, kann ein BSF (Respiratory Filter) verwendet werden, der den Normen ISO 23328-1:2003 und

ISO 23328-2:2002 entspricht und über ein Medizinproduktezertifikat verfügt.

(1) Verschiedene Patienten müssen ein neues BSF ersetzen, bevor sie dieses Gerät verwenden.

(2) Wenn Sie BSF verwenden, folgen Sie bitte den Anweisungen von BSF, um zu installieren und zu betreiben. Achten Sie darauf, die Ausgangsdruckeinstellung des Geräts entsprechend dem Widerstand von BSF einzustellen, um den normalen Verarbeitungsdruck für den Transport sicherzustellen.

(3) Zerstäubung oder Befeuchtung erhöht den Widerstand von BSF. Der Bediener muss den erhöhten Widerstand und die Verstopfung des BSF regelmäßig überwachen, um einen normalen Behandlungsdruck für die Förderung sicherzustellen.

- Wenn Sie Ozon oder andere Reinigungs- und Desinfektionsmethoden verwenden, die von BMC nicht empfohlen werden, kann BMC die Sicherheit oder Leistung des Geräts nicht überprüfen.

VORSICHTSHINWEISE!

- Eine Überhitzung der Materialien könnte zu einer frühzeitigen Ermüdung dieser Materialien führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts und seines Zubehörs keine Lösungen, die Chlorkalk, Chlor oder Aromastoffe enthalten. Auch Flüssigseife, die ein Befeuchtungsmittel oder antimikrobielle Zusätze enthält, sollte nicht verwendet werden. Diese Lösungen können gereinigte Materialien verhärten oder deren Lebensdauer verkürzen.

- Reinigen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht mit Wasser über 80°C (176°F) und trocknen Sie es nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur über 80°C (176°F) liegt. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in irgendwelche Flüssigkeiten ein.

- Desinfektionsmittel neigen dazu, Materialien zu beschädigen und die Lebensdauer von Komponenten zu verkürzen. Versuchen Sie, ein geeignetes Desinfektionsmittel auszuwählen und befolgen Sie die Anweisungen und Empfehlungen des Desinfektionsmittelherstellers.

- Führen Sie nach der Desinfektion eine Sichtprüfung des Kopfbandes und der Maske auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Brüchen durch. Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

19.1 Reinigung

19.1.1 Reinigen der Maske und des Kopfbandes

Finden Sie die Details in den Reinigungsanweisungen im Benutzerhandbuch der Maske.

19.1.2 Reinigung der Schläuche

Weitere Informationen finden Sie in den Reinigungsanweisungen im Benutzerhandbuch des L1-Rohr.

19.1.3 Austausch des Luftfilters

- (1) Öffnen Sie die Luftfilterkappe, um den Luftfilter zu entfernen.
- (2) Setzen Sie den neuen Luftfilter in den Filterbereich ein, und bringen Sie dann die Filterkappe wieder richtig an, wie in Abb. 19-1 dargestellt.




Abb. 19-1

VORSICHTSHINWEISE!

- Um Sachschäden zu vermeiden, sollte der Ersatzluftfilter nicht in direktem Sonnenlicht, in feuchter Umgebung oder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert werden. Der Luftfilter sollte mindestens alle 6 Monate ausgetauscht werden (der Austausch kann je nach örtlicher Luftqualität verkürzt werden, bitte ersetzen Sie ihn bei Beschädigung und Rissen). Er sollte nicht gewaschen werden.
- Bei Betrieb des Geräts mit einem verschmutzten Luftfilter kann das Gerät nicht mehr richtig funktionieren und beschädigt werden.

19.2 Desinfektion

19.2.1 Desinfektion der Maske und des Kopfbandes

Einzelheiten hierzu finden Sie in den Desinfektionsanweisungen in der Gebrauchsanweisung der Maske.

19.2.2 Desinfektion der Schläuche

Einzelheiten finden Sie in den Desinfektionsanweisungen im Benutzerhandbuch des L1.

20. Reisen mit dem Gerät

20.1 Reisen

- (1) Verwenden Sie den BMC-Koffer, um das Gerät und das Zubehör mit sich zu führen. Geben Sie diese nicht in Ihr aufgegebenes Gepäck.

(2) Dieses Gerät arbeitet mit Netzspannungen von 100 V bis 240 V und 50 Hz/60 Hz und ist für den Einsatz in allen Ländern der Welt geeignet. Es ist keine besondere Einstellung erforderlich, aber Sie müssen sich über die Art der Steckdosen an Ihrem Zielort informieren. Bringen Sie ggf. einen Steckdosenadapter mit, welchen Sie in Elektronikgeschäften kaufen können.

(3) Denken Sie daran, einen Ersatzluftfilter und die Notfalldokumente (ausgefüllt und von Ihrem Arzt unterschrieben) dieses Gerätes mitzubringen. Wenn Sie eine Flugreise planen, denken Sie daran, mehrsprachige Notfalldokumente über die Atemtherapie mitzubringen, für den Fall, dass die Grenz- und Zollbeamten in Ihrem Zielland das Gerät kontrollieren. Mit den Notfalldokumenten können Sie ihnen beweisen, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt.

(4) Sicherheitsstationen: Zur Erleichterung von Kontrollen an Sicherheitsstationen befindet sich auf der Unterseite des Geräts ein Hinweis, dass es sich um ein medizinisches Gerät handelt. Es kann hilfreich sein, dieses Handbuch mitzubringen, damit das Sicherheitspersonal das Gerät leichter verstehen können.

VORSICHTSHINWEISE!

- Wenn das Gerät verwendet wird, wenn der atmosphärische Druck außerhalb des angegebenen Bereichs liegt (siehe Abschnitt 6), wird die Genauigkeit des Leckage-Alarms beeinträchtigt.

20.2 Reisen mit dem Flugzeug

Bei einigen Fluggesellschaften werden medizinische Geräte nicht auf das Handgepäck angerechnet. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach deren Richtlinien für medizinische Geräte.

Sie können Ihren M1 Mini im Flugzeug verwenden, da er die Anforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) erfüllt.

WARNUNG!

- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, doppelklicken Sie auf die Bluetooth-Taste  auf dem Gerät, um die Verwendung der drahtlosen Bluetooth-Technologie zu beenden (in den Flugzeugmodus wechseln).
- Verwenden Sie die LightTrip App nicht, wenn Sie im Flugzeug sitzen. Verwenden Sie die **Start/Stop-Taste**  auf dem Gerät, um die Therapie zu starten oder zu beenden.
- Um die Verbindung über die drahtlose Bluetooth-Technologie wiederherzustellen (Flugzeugmodus beenden), drücken Sie die Bluetooth-Taste  am Gerät.

21. Weitergabe des Geräts an einen anderen Patienten

Wenn das Gerät an einen anderen Patienten weitergegeben wird, sollten die Komponenten, die in engem Kontakt mit dem Vorbesitzer standen, einschließlich Maske, Kopfband, Schlauch und Luftfilter, gereinigt und desinfiziert werden, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.

22. Nachbestellung

Kontaktieren Sie Ihren Heimpflege-Dienstleister, um Zubehör oder Ersatzfilter zu bestellen. Das Gerät braucht keine routinemäßige Wartung.

WARNUNGEN!

- Stellen Sie die Verwendung des Gerätes ein und kontaktieren Sie Ihren Heimpflege-Dienstleister, wenn Sie unerklärliche Veränderungen der Leistung des Geräts feststellen, wenn es ungewöhnliche oder raue Geräusche von sich gibt, wenn es fallen gelassen oder falsch behandelt wurde, wenn das Gehäuse zerbrochen ist oder wenn Wasser in das Gehäuse eingedrungen ist.
- Kontaktieren Sie sich bei einer Fehlfunktion des Geräts sofort Ihren Heimpflege-Dienstleister. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Geräts zu öffnen. Reparaturen und Einstellungen dürfen nur von BMC-autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden. Unautorisierter Service kann zu Verletzungen, zum Erlöschen der Garantie oder zu kostspieligen Schäden führen.
- Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren autorisierten Händler oder an BMC Medical Co., Ltd.

23. Technische Unterstützung

Bitte kontaktieren Sie BMC direkt, wenn Sie den Schaltplan des Geräts und die Komponentenliste für bestimmte Zwecke wie z. B. Wartung oder Anschluss an andere Geräte benötigen. BMC stellt Ihnen den Schaltplan und/oder andere technische Unterlagen ganz oder teilweise nach Ihren Wünschen zur Verfügung.

24. Entsorgung

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften der Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 (RoHs) zur Beschränkung von gefährlichen Stoffen.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) über Elektro- und Elektronikgeräte dürfen Produkte nicht unüberlegt entsorgt werden und müssen in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem die Entsorgung erfolgt, entsorgt werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne  bedeutet, dass das mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern getrennt entsorgt werden muss. Diese Forderung nach getrennter Entsorgung basiert auf der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronikgeräte. Sie können das Produkt z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle abliefern. Dies verringert die Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen und verhindert die Verunreinigung der Umwelt durch die Freisetzung gefährlicher Stoffe.

Für weitere Informationen zur Produktentsorgung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

25. Fehlerbehebung

In der folgenden Tabelle sind häufige Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet, die mit dem Gerät auftreten können. Wenn es keine passenden Problemlösungen gibt, kontaktieren Sie Ihren Heimpflege-Dienstleister.

25.1 Häufige Probleme bei Patienten und entsprechende Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung(en)
Trockene, kalte, laufende und verstopfte Nase; Erkältung	Die Nase reagiert auf den Luftstrom und die Kälte. Durch den schnellen Luftstrom wird die Luft kalt, was zu einer Reizung der Nasenschleimhaut und anschließender Trockenheit und Schwellung führt.	Kontaktieren Sie Ihren Arzt und machen Sie die Behandlung weiter, es sei denn, der Arzt schlägt die gegenteilige Lösung vor.
Trockener Mund und Rachen	Wahrscheinlich, weil der Patient mit offenem Mund schläft und die unter Druck stehende Luft über den Mund entweicht, was zu Nasen- und Rachentrockenheit führt.	Verwenden Sie einen Kinnriemen, um zu verhindern, dass sich der Mund während des Schlafs öffnet, oder verwenden Sie eine Vollgesichtsmaske.
Augenreizung	Die Maskengröße oder das Modell ist möglicherweise nicht korrekt, oder die Maske ist falsch positioniert, was zu Luftundichtigkeiten führt.	Vermindern Sie den Abstand zwischen der Stirnstütze der Maske und der Stirn. Beachten Sie, dass eine zu enge Einstellung der Maske Druckstellen auf dem Gesicht des Patienten hinterlassen kann. Füllen Sie die Maske zusätzlich auf, damit sie nicht undicht wird. Wenden Sie sich an Ihren Ausrüstungslieferant, um eine geeignete Maske zu erhalten. Füllen Sie die Maske bei Bedarf zusätzlich auf.
	Maskenkissen (der weiche Teil der Maske) härtet aus.	Tauschen Sie die Maske oder das Maskenkissen aus.
Gesichtsrotung	Die Maske ist zu eng.	Lösen Sie das Kopfband.
	Der Abstand zwischen der Stirnstütze der Maske und der Stirn ist nicht korrekt.	Probieren Sie einen anderen Abstand aus. Der Winkel und die Größe der Stirnstütze variieren je nach Typ der Masken.
	Falsche Größe der Maske.	Beauftragen Sie Ihren Ausrüstungslieferanten um die richtige Größe der Maske zu erhalten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung(en)
Gesichtsрtung	Der Patient ist allergisch gegen die Materialien der Maske.	Kontaktieren Sie Ihren Arzt und Ausrüstungslieferant. Tragen Sie eine Maske, die nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt wurde. Legen Sie ein Zwischenfutter zwischen Haut und Maske.
Nasen-, Nebenhöhlen- oder Ohrenschmerzen	Sinus- oder Mittelohrentzündung.	Kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt.
Unbehagen aufgrund der Unfähigkeit, sich dem Behandlungsdruck anzupassen	Der Patient wird sich unwohl fühlen, wenn der Behandlungsdruck höher als 13 hPa ist. Der Behandlungsdruck wird jedoch entsprechend den Bedingungen des Patienten festgelegt und kann keine Schlafapnoe behandeln, wenn der Behandlungsdruck zu niedrig eingestellt ist.	Es dauert maximal vier Wochen um sich an die Druckluft anzupassen. Entspannen Sie sich und atmen Sie durch die Nase. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Wiederkehren der Symptome der obstruktiven Schlafapnoe	Es liegt wahrscheinlich daran, dass der Patient mit offenem Mund schläft und die unter Druck stehende Luft über den Mund austritt. Dies verursacht eine Blockade der Atemwege.	Verwenden Sie einen Kinnriemen, um den offenen Mund während des Schlafs zu vermeiden oder verwenden Sie eine Vollgesichtsmaske. Kontaktieren Sie Ihren Arzt für Details.
Das Gerät ist zu laut	Der Schlauch ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Schlauch wieder richtig an.
Die vom Gerät abgegebene Luft ist abnormal heiß	Der Lufteinlass des Geräts ist möglicherweise teilweise blockiert, was zu einem unzureichenden Luftstrom in das Gerät führt.	Tauschen Sie den Luftfilter aus (siehe 19.1.3 Austausch des Luftfilters), und reinigen Sie den Lufteinlass. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Luft frei fließen kann, und achten Sie darauf, dass das Gerät mindestens 20 cm von Wänden, Vorhängen oder anderen Gegenständen entfernt ist.

25.2 Häufige Probleme mit dem Gerät und entsprechende Lösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung(en)
Das Gerät funktioniert nicht, wenn es eingeschaltet ist	Die Funktion "Auto Ein/Aus" ist eingeschaltet.	Atmen Sie bei aufgesetzter Maske einige Mal tief ein, dann startet das Gerät automatisch.
	Das Gerät ist nicht richtig angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Stromadapter und das Gerät richtig angeschlossen sind.
	Es gibt keine Spannung.	Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt, indem Sie ein Licht oder andere Geräte einschalten. Wenn Sie sicher sind, dass die Sicherung im Gerät defekt ist, wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Ausrüstungslieferanten.
	Die Ursache kann nicht gefunden werden.	Kontaktieren Sie Ihre Ausrüstungslieferanten.
Das Gerät funktioniert, aber der Druck in der Maske ist unterschiedlich zum eingestellten Behandlungsdruck	Der Schlauch ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Schlauch wieder richtig an.
	Es könnte Löcher in der Maske oder im Druckmessschlauch geben.	Kontaktieren Sie Ihre Ausrüstungslieferanten.
	Es ist ein kaputtes Gerät.	Kontaktieren Sie Ihre Ausrüstungslieferanten.
	Die Auswirkungen von degradierten Sensoren und Elektroden oder gelockerten Elektroden.	Kontaktieren Sie Ihre Ausrüstungslieferanten.
Das Gerät baut einen sehr niedrigen Druck auf	Der Lufteinlass des Geräts kann blockiert sein.	Tauschen Sie den Luftfilter aus (siehe 19.1.3 Austausch des Luftfilters), und reinigen Sie den Lufteinlass. Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass nicht blockiert ist.
	Der Behandlungsdruck wurde unabsichtlich geändert.	Kontaktieren Sie Ihren Arzt.
	Wenn die Rampenfunktion eingeschaltet ist, dauert es einige Zeit, bis der Anfangsdruck auf den Behandlungsdruck erhöht ist. Das ist normal.	Deaktivieren Sie ggf. die Rampenfunktion oder stellen Sie die Rampenzeit kürzer ein.
Das Gerät befindet sich im Ruhemodus und wird nicht starten	Das Betriebssystem des Geräts soll neu eingestellt oder neu gestartet werden.	Trennen Sie den Netzstecker des Geräts, und stecken Sie ihn 20 Sekunden später wieder ein.

26. Anforderungen von EMV

Die Kabel müssen von BMC bereitgestellt werden. Die Information des einzelnen Kabels ist wie folgt:

(1) Netzteil: 1800 mm $\pm$ 45 mm, ungeschirmt

(2) Schlauchs: 1800 mm $\pm$ 10%, ungeschirmt

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Emissionen	
Das Gerät ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde bzw. der Anwender des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.	
Emissionstest	Konformität
RF-Emissionen CISPR 11	Gruppe 1
RF-Emissionen CISPR 11	Klasse B
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	N/A
Spannungsschwankungen/Flicker-Emissionen IEC 61000-3-3	N/A

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Gerät ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde bzw. der Anwender des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Prüfung der Störfestigkeit	IEC 60601 Prüfstufe	Konformitätsstufe
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft
Elektrische Störimpulse (EFT)/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für Stromversorgungsleitungen	±2 kV für Stromversorgungsleitungen
Anstieg IEC 61000-4-5	±1 kV Leitung(en) zu Leitung(en)	±1 kV Leitung(en) zu Leitung(en)
Spannungseinbrüche, Kurzunterbrechungen und Spannungsschwankungen auf Stromversorgungseingangsleitungen IEC 61000-4-11	0% U_T ; 0,5 Zyklus Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0% U_T ; 1 Bei 70% U_T ; 25/30 Zyklus Bei 0° 0% U_T ; 250/300 Zyklus	0% U_T ; 0,5 Zyklus Bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0% U_T ; 1 Zyklus 70% U_T ; 25/30 Zyklus Bei 0° 0% U_T ; 250/300 Zyklus
Netzfrequenz (50 Hz/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m

HINWEIS: U_T ist die Wechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels.

Leitfaden und Herstellererklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Gerät ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde bzw. der Anwender des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung eingesetzt wird.

Prüfung der Störfestigkeit	IEC 60601 Prüfstufe	Konformitätsstufe
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz bis 80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz	3 V 0,15 MHz bis 80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz
Gestrahlte HF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz

HINWEIS 1: Im Bereich von 80 MHz bis 800 MHz wird der höhere Frequenzbereich eingesetzt.

HINWEIS 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.

^a Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie z. B. Basisstationen für Funktelefone (zellulare/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräten, Amateurfunk, AM- und FM-Radio- und Fernsehsendungen können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung durch ortsfeste HF-Sender zu beurteilen, sollte ein elektromagnetisches Standortgutachten in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das Gerät verwendet wird, den oben angegebenen HF-Konformitätspegel überschreitet, sollte das Gerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn ein abnormales Verhalten beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des Geräts.

^b Wenn der Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz überschritten ist, sollten die Feldstärken kleiner als 10 V/m sein.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Gerät

Das Gerät ist für die Verwendung in elektromagnetischer Umgebung, in der HF-Störgrößen kontrolliert sind, vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des Geräts kann elektromagnetische Störungen verhindern, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Transmittern) und dem Gerät wahrt, wie dies gemäß der maximalen Ausgangsleistung von Kommunikationsgeräten angegeben ist.

Maximale Ausgangsleistung des Transmitters (W)	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 0,35\sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = 0,70\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,04	0,07
0,1	0,37	0,12	0,23
1	1,17	0,35	0,70
10	3,70	1,11	2,22
100	11,7	3,50	7,00

Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt die höhere angewendete Frequenz.

Hinweis 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Situationen anwendbar sein. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Für Transmitter mit einer maximalen Ausgangsleistung, die nicht oben aufgeführt ist, der empfohlene Trennungsabstand d in Metern (m) kann Verwendung mit der geltenden Gleichung zur Frequenz des Transmitters abgeschätzt werden. P ist die maximale Ausgangsnennleistung des Transmitters in Watt (W) gemäß den Angaben des Transmitterherstellers.

Empfohlene Abstände zwischen drahtlosen HF-Kommunikationsgeräten

Das Gerät ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Benutzer des Geräts kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen drahtlosen HF-Kommunikationseinrichtungen und dem Gerät einhält, wie unten empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Frequenz (MHz)	Maximale Leistung (W)	Abstand	IEC 60601 Prüfstufe	Konformitätsstufe
385	1,8	0,3	27	27
450	2	0,3	28	28
710	0,2	0,3	9	9
745				
780				
810	2	0,3	28	28
870				
930				
1720	2	0,3	28	28
1845				
1970				
2450	2	0,3	28	28
5240	0,2	0,3	9	9
5500				
5785				

HINWEIS: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst.

Leitlinien und Herstellererklärungen - Elektromagnetische Störfestigkeit

Dieses Gerät ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Benutzer des Geräts sollte sicherstellen, dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Immunologischer Test	IEC 60601 Teststufen	Niveau der Einhaltung
Magnetisches Feld in der Nähe IEC 61000-4-39	Siehe Tabelle 1	Siehe Tabelle 1

Tabelle 1

Testfrequenz	Modulation	Immunität Testpegel (A/m)
30 kHz ^{a)}	Pulsmodulation ^{b)} CW	8
134,2 kHz	Pulsmodulation ^{b)} 2,1 kHz	65 ^{c)}
13,56 MHz	50 kHz	7,5 ^{c)}
^{a)} Diese Prüfung gilt nur für MEGERÄTE und ME-SYSTEME, die für die Verwendung in der HÄUSLICHEN GESUNDHEITSPFLEGEUMGEBUNG vorgesehen sind. ^{b)} Dieser Träger wird mit einem Rechtecksignal mit 50% Tastverhältnis moduliert. ^{c)} r.m.s., vor Anwendung der Modulation.		

WARNUNGEN!

- Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm zu irgendeinem Teil des M1 Mini verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Leistung dieses Geräts kommen. Wenn dies der Fall ist, sollte das Gerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen.
- Die Verwendung von anderen als den angegebenen Zubehörteilen und Netzteilen, mit Ausnahme von Kabeln, die vom Hersteller des Geräts oder Systems als Ersatzteile für interne Komponenten verkauft werden, kann zu erhöhten Emissionen oder verminderter Störfestigkeit des Geräts oder Systems führen.
- Dieses Gerät kann durch andere Geräte gestört werden, selbst wenn diese anderen Geräte die CISPR EMISSIONS-Anforderungen erfüllen.
- Während des Betriebs des Gerätes können aufgrund elektrostatischer Störungen die folgenden Phänomene auftreten: (1) Vorübergehender Funktionsverlust oder Beeinträchtigung der Leistung, wie z. B. abnormale Bildschirmanzeige usw. Das Gerät wird nach einem Neustart wieder normal funktionieren; (2) Automatischer Neustart des Gerätes. Diese Phänomene haben keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch des Geräts und führen nicht zu einer dauerhaften Leistungsminderung oder einem Funktionsverlust des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit MRT-Geräten vorgesehen und darf nicht in MR-Umgebungen verwendet werden.

27. Eingeschränkte Garantie

BMC Medical Co., Ltd. garantiert, dass das Gerät frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist und in Übereinstimmung mit den Produktspezifikationen funktioniert, und zwar für einen Zeitraum von einem (1) Jahr für das Hauptgerät und von drei (3) Monaten für alle Zubehörteile ab dem Datum des Verkaufs durch BMC Medical Co., Ltd. an den Händler. Wenn das Produkt nicht den Produktspezifikationen entspricht, wird BMC Medical Co., Ltd. nach eigenem Ermessen das defekte Material oder Teil reparieren oder ersetzen. BMC Medical Co., Ltd. übernimmt nur die üblichen Frachtkosten von BMC Medical Co., Ltd. zum Standort des Händlers. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen und andere Defekten verursacht wurden, die nicht mit Material oder Verarbeitung zusammenhängen.

BMC MEDICAL CO., LTD. LEHNT JEGLICHE HAFTUNG FÜR WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE, GEWINNVERLUSTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN AB, DIE SICH AUS DEM VERKAUF ODER DER VERWENDUNG DIESER PRODUKTS ERGEBEN KÖNNTEN. IN EINIGEN STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT.

Um die Rechte aus dieser Garantie auszuüben, wenden Sie sich an die örtlichen Vertragshändler oder:

HERSTELLER:

BMC Medical Co., Ltd.

Zimmer 110 Gebäude A Fengyu Gebäude, Nr. 115 Fucheng Straße Haidian,
100036 Beijing, V.R.China

Telefon: +86-10-51663880

URL: en.bmc-medical.com

E-mail: intl@bmc-medical.com

EU-BEVOLLMÄCHTIGTER:

Shanghai International Holding GmbH (Europa)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Deutschland

Tel: 0049-40-2513175

Fax: 0049-40-255726

